


Настройка ИЭМК

- Переход к настройкам ИЭМК
- Настройка «Виды лабораторных исследований»
- Настройка «Виды инструментальных исследований»
- Настройка «Виды профилактических осмотров»
- Настройка «Отображаемые типы результатов видов диспансеризации»
- Настройка «Адрес сервиса ИЭМК v1»
- Настройка «Адрес справочной информации»

Переход к настройкам ИЭМК

Для выполнения настроек ИЭМК необходимо на главной странице Системы выбрать раздел «Настройки ИЭМК».

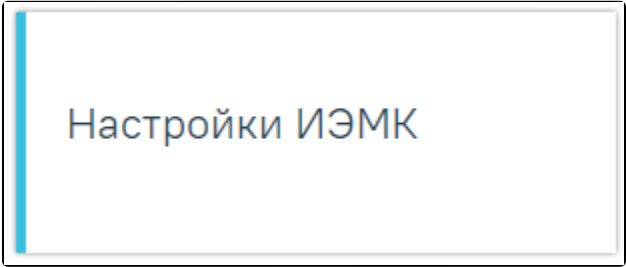

Раздел «Настройки ИЭМК»

Осуществится переход в раздел «Настройки ИЭМК», содержащий настройки:

- виды лабораторных исследований;
- виды инструментальных исследований;
- виды профилактических осмотров;
- отображаемые типы результатов видов диспансеризации;
- адрес сервиса ИЭМК v1;
- адрес справочной информации.

Администрирование ИЭМК / Настройки ИЭМК

Администратор

Настройки ИЭМК

Виды лабораторных исследований

402 – Аллергологические исследования

403 – Аутоиммунная диагностика

201, 777 – Биохимические исследования

3 – Биохимические исследования (электролиты, субстраты, белки, ферменты, липиды)

101, 1, 16 – Гематологические исследования

4 – Дорогостоящие методы лучевой диагностики

401 – Иммунологические исследования

13 – Иммунохимическое определение витаминов

11 – Иммунохимическое определение маркеров внематочной беременности

4 – Исследование гемостаза (клеточные тесты и подтверждающие)

10 – Исследование уровня онкомаркеров

9 – Исследование уровня гормонов в крови

301 – Коагулологические исследования

1 – Лабораторная диагностика

8 – Лабораторные исследования для централизованного обследования беременных женщин

601 – Микробиологические исследования

15 – Молекулярная диагностика

450 – Молекулярно-диагностические исследования

451 – Молекулярно-биологические исследования

49 – Общеклинический отдел

7 – Определение маркеров инфекционных заболеваний

2 – Определение групп крови и резус фактора, фенотипирование эритроцитов

6 – Определение уровня специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови для диагностики аллергозов

5 – Специфические тесты (Д-димер, тропанин, гликозилированный гемоглобин, миоглобин, гликемический профиль)

102 – Химико-микроскопические исследования

701 – Химико-токсикологические исследования

501 – Цитологические исследования

602 – Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам

Виды инструментальных исследований

Виды профилактических осмотров

Отображаемые типы результатов видов диспансеризации

Адрес сервиса ИЭМК v1

Адрес справочной информации

https://confluence.softtrust.ru/pages/viewpage.action?pageId=46305721

Сохранить

Раздел «Настройки ИЭМК»

Настройка «Виды лабораторных исследований»

Настройка «Виды лабораторных исследований» определяет перечень видов исследований, которые должны отображаться в разделе «Результаты лабораторных исследований» ИЭМК.

Для настройки лабораторных исследований следует заполнить настройку «Виды лабораторных исследований». По умолчанию поле «Виды лабораторных исследований» пустое. В поле доступен множественный выбор из справочника. Для удаления значения из поля следует нажать «x» рядом со значением

x 402 – Аллергологические исследования

Виды лабораторных исследований

x 402 – Аллергологические исследования

x 403 – Аутоиммунная диагностика

x 201, 777 – Биохимические исследования

x __3 – Биохимические исследования (электролиты, субстраты, белки, ферменты, липиды)

x 101, __1, __16 – Гематологические исследования

x 4 – Дорогостоящие методы лучевой диагностики

x 401 – Иммунологические исследования

x __13 – Иммунохимическое определение витаминов

x __11 – Иммунохимическое определение маркеров анемий

x __4 – Исследование гемостаза (клеттинговые тесты и подтверждающие)

x __10 – Исследование уровня онкомаркеров

x __9 – Исследования уровня гормонов в крови

x 301 – Коагулогические исследования

x 1 – Лабораторная диагностика

x __8 – Лабораторные исследований для централизованного обследования беременных женщин

x 601 – Микробиологические исследования

x __15 – Молекулярная диагностика

x 450 – Молекулярная диагностика инфекционных заболеваний

x 451 – Молекулярно-биологические исследования

x __49 – Общеклинический отдел

x __7 – Определение маркеров инфекционных заболеваний

x __2 – Определение групп крови и резус фактора, фенотипирование эритроцитов

x __6 – Определение уровня специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови для диагностики аллергозов

x __5 – Специфические тесты (Д-димер, тропанин, гликозилированный гемоглобин, миоглобин, гликемический профиль)

x 102 – Химико-микроскопические исследования

x 701 – Химико-токсикологические исследования

x 501 – Цитологические исследования

x 602 – Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам

__17 – Диагностика вирусных гепатитов В и С, ВИЧ

__D001 – Диспансеризация

32, __32 – Другие рентгенологические исследования с их последующим описанием


33, __33 – Другие ультразвуковые исследования

34, __34 – Дуплексное сканирование сосудов

Заполнение поля «Виды лабораторных исследований»

Для заполнения полей «Виды инструментальных исследований», «Виды лабораторных исследований» используется один справочник. Исследование, выбранное в одном поле, не может быть выбрано в другом.

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить». В результате успешного сохранения отобразится сообщение об успешном сохранении настроек.

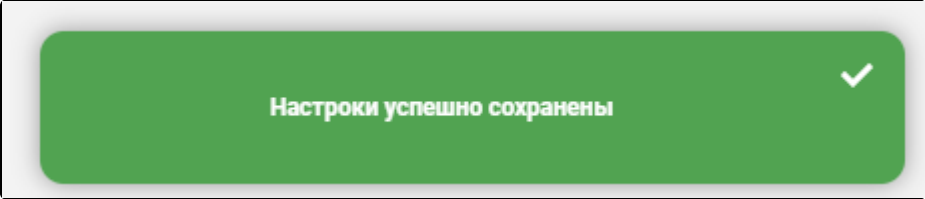

Сообщение об успешном сохранении настроек

Настройка «Виды инструментальных исследований»

Настройка «Виды инструментальных исследований» определяет перечень видов исследований, которые должны отображаться в разделе «Результаты инструментальных исследований» ИЭМК.

Для настройки инструментальных исследований следует заполнить настройку «Виды инструментальных исследований». По умолчанию поле «Виды инструментальных исследований» пустое. В поле доступен множественный выбор из справочника. Для удаления значения из поля следует нажать x рядом со значением

x 1, 48, __48 – Флюорография

Виды инструментальных исследований

x 1, 48, __48 – Флюорография
 x 45, __45 – Электроодонтометрия
 x 46 – Электроэнцефалография

34, __34 – Дуплексное сканирование сосудов

22 – Иное

2 – Инструментальная диагностика

51 – Исследования нижних дыхательных путей и легочной ткани

9 – Комплексное исследование (рентгенография и томография)

Заполнение поля «Виды инструментальных исследований»

Для заполнения полей «Виды инструментальных исследований», «Виды лабораторных исследований» используется один справочник. Исследование, выбранное в одном поле, не может быть выбрано в другом.

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить». В результате успешного сохранения отобразится сообщение об успешном сохранении настроек.

Настройка «Виды профилактических осмотров»

Настройка «Виды профилактических осмотров» определяет перечень видов профилактических осмотров, которые должны отображаться в разделе «Профилактика» ИЭМК.

Для настройки профилактических осмотров следует заполнить настройку «Виды профилактических осмотров». По умолчанию поле «Виды профилактических осмотров» пустое. В поле доступен множественный выбор из справочника. Для удаления значения из поля следует нажать «x» рядом со значением

x 124нП – 124н Профилактические медицинские осмотры

Виды профилактических осмотров

x — x 124нП – 124н Профилактические медицинские осмотры
 x 344н-1 – Водительская справка А,В,М
 x 344н-2 – Водительская справка С,Д,Т

x 834н – Врачебное профессионально-консультативное заключение
 x 124нД – Диспансеризация
 x 36ан-2 – Диспансеризация 2 Этап

x ДН – Диспансерное наблюдение
 x 441н – Справка на владение оружием

514н – 514н Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних

302н – Диспансерное наблюдение несовершеннолетних

Заполнение поля «Виды профилактических осмотров»

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить». В результате успешного сохранения отобразится сообщение об успешном сохранении настроек.

Настройка «Отображаемые типы результатов видов диспансеризации»

Настройка «Отображаемые типы результатов видов диспансеризации» определяет перечень типов результатов, которые должны отображаться в разделе «Профилактика» ИЭМК.

Для настройки типов результатов следует заполнить настройку «Отображаемые типы результатов видов диспансеризации». По умолчанию поле «Отображаемые типы результатов видов диспансеризации» пустое. В поле доступен множественный выбор из справочника. Для удаления значения из поля

следует нажать x рядом со значением

x 1 – Заключение

Отображаемые типы результатов видов диспансеризации

x 1 – Заключение x 2 – Факторы риска x 3 – Отягощенная наследственность x 4 – Факторы риска (стоматология) x 2 – Рекомендации

5 – Отягощенная наследственность
 10 – Общий медицинский анамнез (ортодонтия)
 13 – Осмотр лица. Кефалометрия
 14 – Лицо в анфас
 15 – Лицо в профиль

Заполнение поля «Отображаемые типы результатов видов диспансеризации»

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить». В результате успешного сохранения отобразится сообщение об успешном сохранении настроек.

Настройка «Адрес сервиса ИЭМК v1»


Настройка «Адрес сервиса ИЭМК v1» определяет возможность перехода в предыдущую версию ИЭМК из текущего модуля ИЭМК. Для включения настройки необходимо заполнить поле «Адрес сервиса ИЭМК v1». Поле заполняется вводом данных с клавиатуры.

Адрес сервиса ИЭМК v1

http://

Заполнение поля «Адрес сервиса ИЭМК v1»

После заполнения настройки «Адрес сервиса ИЭМК v1» в интерфейсе ИЭМК отображается иконка перехода в предыдущую версию ИЭМК. Предыдущая версия ИЭМК открывается в новой вкладке.

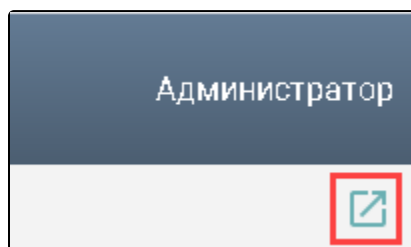


Отображение иконки перехода в предыдущую версию ИЭМК при заполненной настройке «Адрес сервиса ИЭМК v1»

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить». В результате успешного сохранения отобразится сообщение об успешном сохранении настроек.

Настройка «Адрес справочной информации»

Настройка «Адрес справочной информации» определяет возможность перехода на страницу справочной информации по работе с модулем ИЭМК. В шапке страницы отображается значок , при наведении курсора на значок появится всплывающая подсказка.

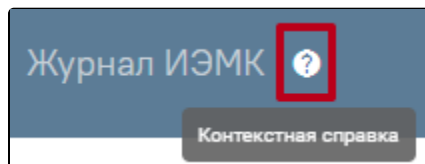

Контекстная справка

Для включения настройки необходимо заполнить поле «Адрес справочной информации». Поле заполняется вводом данных с клавиатуры.

Адрес справочной информации

<https://confluence.softtrust.ru/pages/viewpage.action?pagelId=46305721>

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить». В результате успешного сохранения отобразится сообщение об успешном сохранении настроек.