

Работа с ресурсом «Оборудование»

После того, как оборудование добавлено в справочнике и для него указаны МО и отделение, к которому оно относится, необходимо установить признак доступности оборудования в расписании в структуре медицинской организации. Необходимо найти отделение, в которое добавлено оборудование и перейти во вкладку «Оборудование».

Поликлиника

Отделение профилактики (углубленная диспансеризация)

Кабинет врача-терапевта

Кабинет врача-стоматолога

Процедурный кабинет

Кабинет вакцинопрофилактики

Общие сведения об отделении

Характеристики

Персонал

Кабинеты

Оборудование

Комиссии

Бригады

Строк на странице: 5 Записей: 1

Наименование	Код	Кабинет	Описание	Специализация	Период работы	Отображать в расписании
FUKUDA M-E CARDISUNY C320				90 - Хирургия	Действует с 13.10.2021	Да

Добавить ресурс оборудования

Вкладка «Оборудование» в структуре медицинской организации

Для добавления оборудования следует нажать кнопку «Добавить ресурс оборудования» отобразится форма «Добавление ресурса оборудования».

Я

Оказываемые услуги

Тип оборудования

Телеуправляемые поворотные столы-штативы с функцией рентгеноскопии

Отделение *

Профиль

Дата *

20.06.2024

Выведен из эксплуатации

Дата вывода



Доступна запись в лист ожидания

Заккрыть

Сохранить

Форма «Добавление ресурса оборудования»

Форма «Добавление ресурса оборудования» состоит из вкладок «Общие сведения», «Характеристики» и «Оказываемые услуги». Во вкладке «Общие сведения» обязательными для заполнения являются поля:

- «Оборудование» — заполняется путем выбора значения из справочника оборудования, которое создано в этом отделении и имеет признак «Активные».
- «Специализация» — следует указать специализацию оборудования, выбрав нужную запись в справочнике, открываемого щелчком мыши по нему или кнопки . Специализация оборудования должна быть указана для правильного отображения расписания оборудования на портале самозаписи пациентов к врачу. Поле обязательно для заполнения, если не заполнено поле «Виды проводимых исследований»
- «Виды проводимых исследований» — следует указать виды проводимых исследований, выбрав нужную запись в справочнике, открываемого щелчком мыши по нему или кнопки . В поле можно указать несколько значений. Виды проводимых исследований должны быть указаны для сопоставления ресурса «Оборудование» с видами исследований. Поле обязательно для заполнения, если не заполнено поле «Специализация».
- «Дата» — по умолчанию заполнено текущей датой, доступно для редактирования.

Поле «Кабинет» заполняется путем выбора значения из справочника. Справа от поля «Отделение» отображается флажок «Фильтровать по отделению». Если флажок установлен, в поле «Кабинет» доступны только кабинеты из текущего отделения. Если флажок снят, в поле «Кабинет» доступны кабинеты в рамках текущего подразделения. При наведении на флажок отобразится соответствующая всплывающая подсказка.

Флажок «Фильтровать по отделению»

Поле «Описание» заполняется вручную с клавиатуры.

Поля «Тип оборудования», «Медицинская организация» и «Отделение» предзаполняются данными выбранного оборудования из справочника оборудования, поля недоступны для редактирования.

☒ Доступен в расписании

Необходимо заполнить поле «Специализация» и установить флажок

для того, чтобы оборудование

стало доступно в расписании. Для работы с ЕРИС поле «Специализация» должно быть заполнено.

Для ресурса «Оборудование» указываются вид медицинской помощи и профиль. Поля заполняются выбором значения из соответствующих справочников.

☒ Выведен из эксплуатации

В случае вывода оборудования из эксплуатации необходимо установить флажок

. При установке

флажка «Выведен из эксплуатации» поле «Дата вывода» становится активным и обязательным для заполнения, в поле «Дата вывода» нельзя указать дату раньше, чем дата производства. По умолчанию поле «Дата вывода» заполнено текущей датой.

☒ Доступна запись в лист ожидания

Признак

позволяет производить запись в лист ожидания на данный ресурс.

Признак может быть установлен, только если установлен признак «Доступен в расписании».

Сохранить

После заполнения всех полей следует нажать кнопку для сохранения введенных данных.

Если в поле «Кабинет» выбран кабинет, выведенный из эксплуатации, при нажатии кнопки «Сохранить» отобразится сообщение об ошибке.

Сообщение об ошибке

Заккрыть

Для закрытия вкладки без сохранения следует нажать кнопку



Оборудование можно удалить, нажав кнопку

. Для подтверждения удаления оборудования следует нажать кнопку «Да».


Наименование	Код	Кабинет	Описание	Специализация	Период работы	Отображать в расписании
				22 - Детская эндокринология	Действует с 03.05.2022	Да

Вы действительно хотите удалить оборудование?


Нет Да

Удаление оборудования


При удалении оборудования проверяется, существует ли у оборудования расписание, записи на прием, ресурс. При наличии указанных связей оборудование не будет удалено и появится сообщение об ошибке. В таком случае необходимо сначала удалить все связанные с оборудованием данные, а затем удалить само оборудование.

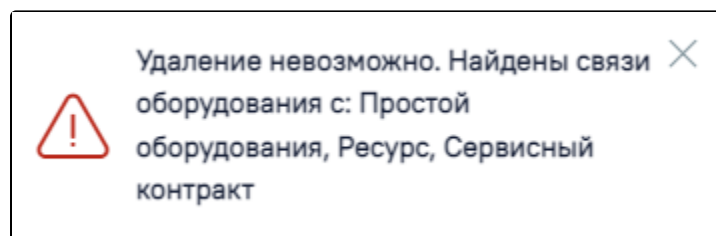


Сообщение об ошибке

При необходимости сохраненное оборудование можно редактировать, для этого следует в строке с нужным оборудованием нажать кнопку , после чего откроется страница «Редактирование ресурса оборудования» с заполненными полями. При редактировании ранее сохраненного оборудования поля «Оборудование», «Тип оборудования», «Медицинская организация» и «Отделение» недоступны для заполнения.

Если на форме «Редактирование ресурса оборудования» во вкладке «Оказываемые услуги» есть хотя бы одна услуга, то при смене значений в полях «Специализация» или «Виды проводимых исследований» вкладки «Общие сведения», автоматически будут очищены услуги и отобразятся соответствующие уведомления.

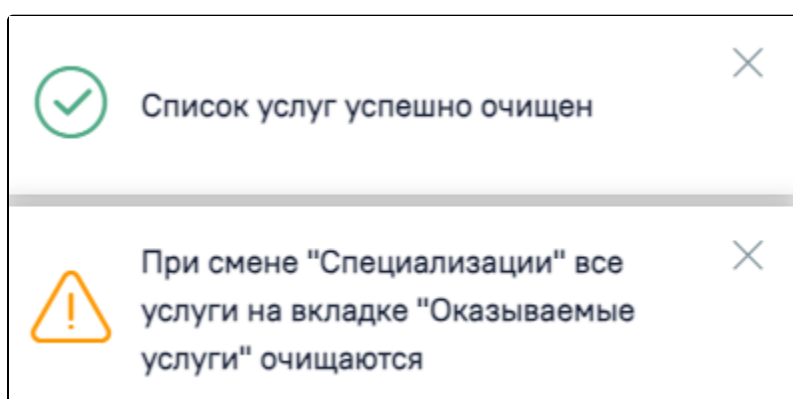

Уведомления при смене значения в поле «Специализация»

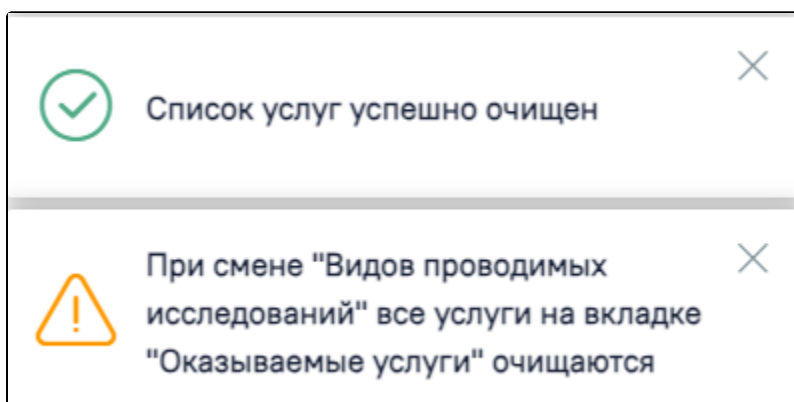


Уведомления при смене значения в поле «Виды проводимых исследований»

Работа во вкладке «Характеристики» оборудования аналогична [вкладке «Характеристики» кабинета](#).


Работа во вкладке «Оказываемые услуги» оборудования аналогична [вкладке «Оказываемые услуги» кабинета](#).

Если установлен признак «Выведен из эксплуатации» при нажатии кнопки «Сохранить» выполняется проверка наличия расписания после даты вывода из эксплуатации, если подтверждено наличие расписания после даты вывода из эксплуатации возникнет ошибка.

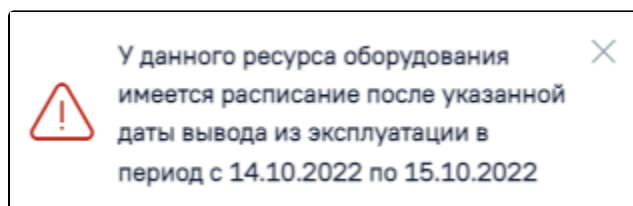

Сообщение об ошибке

Если у ресурса оборудования имеется расписание и признак «Доступен в расписании» не активен, при сохранении данных возникнет ошибка.

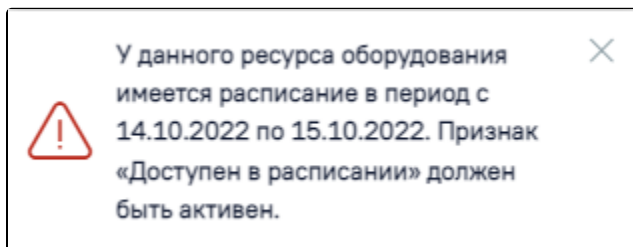

Сообщение об ошибке

Для перехода на [форму «Редактирование оборудования»](#) следует выбрать пункт «Оборудование» в левом боковом меню. Для возврата в структуру МО необходимо выбрать пункт «Структура медицинской организации».

ресурса оборудования

актеристики

Оказываемые услуги

Тип оборудования

102 - Рентгенодиагностические комплексы на 3 рабочих места

Отделение *

X

Описание

едицина

X

Профиль

ий

Дата *

18.06.2024

X

☐ Выведен из эксплуатации

Дата вывода

☐ Доступна запись в лист ожидания

Заккрыть

Сохранить

Пункты «Оборудование» и «Структура медицинской организации» в левом боковом меню